CERTIFIED
DIN EN ISO 9001
NR 70100 F 222
CERTIFICADO

G. LUFFT MESS- UND REGELTECHNIK GMBH
GUTENBERGSTR. 20
70736 FELLBACH
POSTFACH 4252
70719 FELLBACH
TEL: 49 (711) - 51822-0
FAX 49 (711) - 51822-41
INTERNET: http://www.Lufft.de
E-MAIL: Info@Lufft.de

Vergleichsmessung Wetterstation

Station: Argenthal

Sensor: WS 600

Ser.-Nr.: 055.1011.0701.025

Messbeginn: 10:09:16

Messende: 10:34:17

Datum: 09.09.2013 **Bearbeiter:** Reiser

Unterschrift: _____

CERTIFIED
DIN EN ISO 9001
NR 70100 F 222
CERTIFICADO

G. LUFFT MESS- UND REGELTECHNIK GMBH
GUTENBERGSTR. 20
70736 FELLBACH
POSTFACH 4252
70719 FELLBACH
TEL: 49 (711) - 51822-0
FAX 49 (711) - 51822-41
INTERNET: http://www.Lufft.de
E-MAIL: Info@Lufft.de

Temperaturverlauf

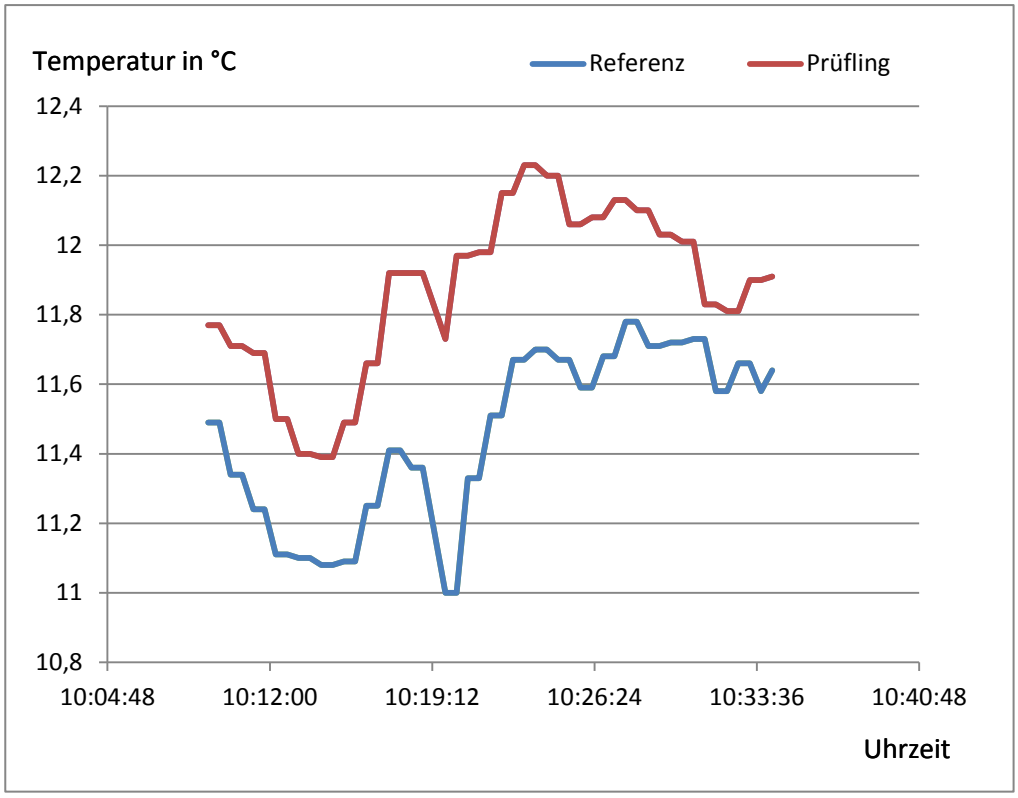

Taupunkttemperaturverlauf

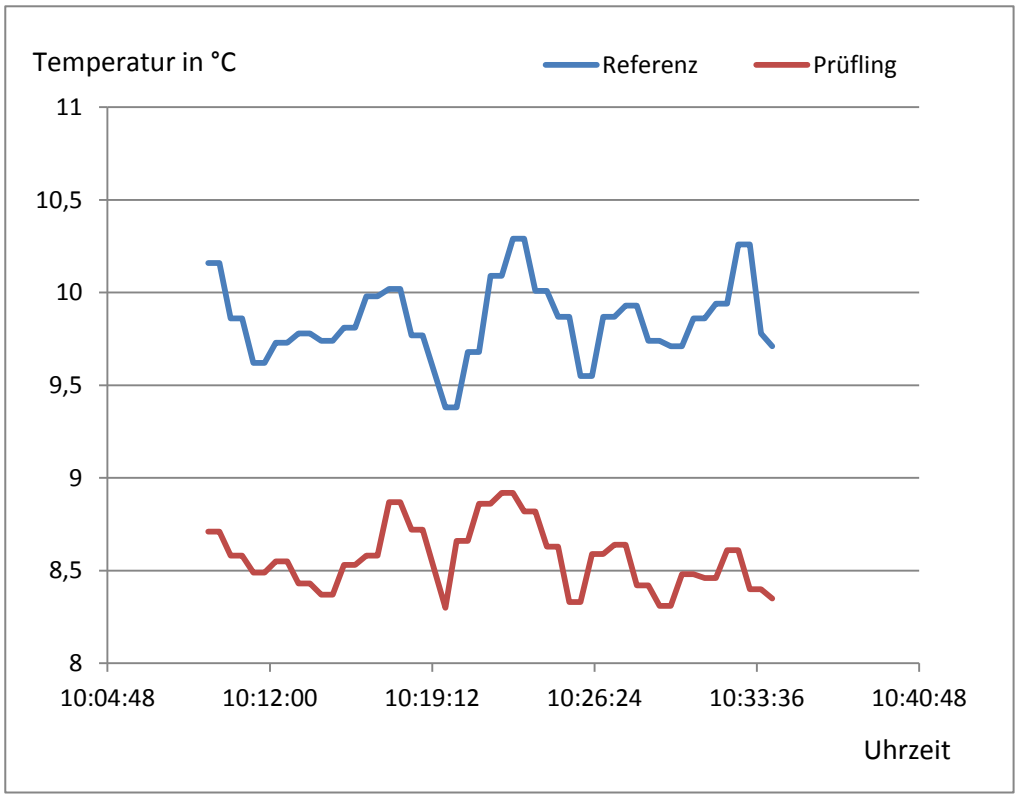

CERTIFIED
DIN EN ISO 9001
NR 70100 F 222
CERTIFICADO

G. LUFFT MESS- UND REGELTECHNIK GMBH
GUTENBERGSTR. 20
70736 FELLBACH
POSTFACH 4252
70719 FELLBACH
TEL: 49 (711) - 51822-0
FAX 49 (711) - 51822-41
INTERNET: http://www.Lufft.de
E-MAIL: Info@Lufft.de

Luftfeuchteverlauf

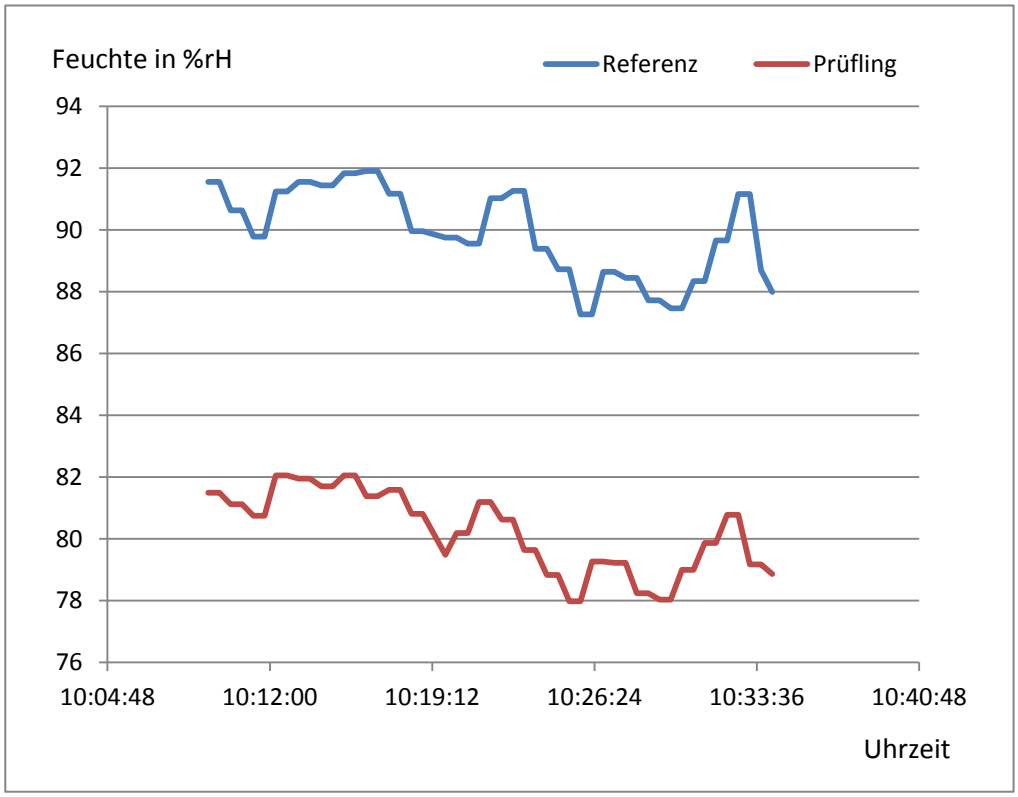

Absolutluftdruckverlauf

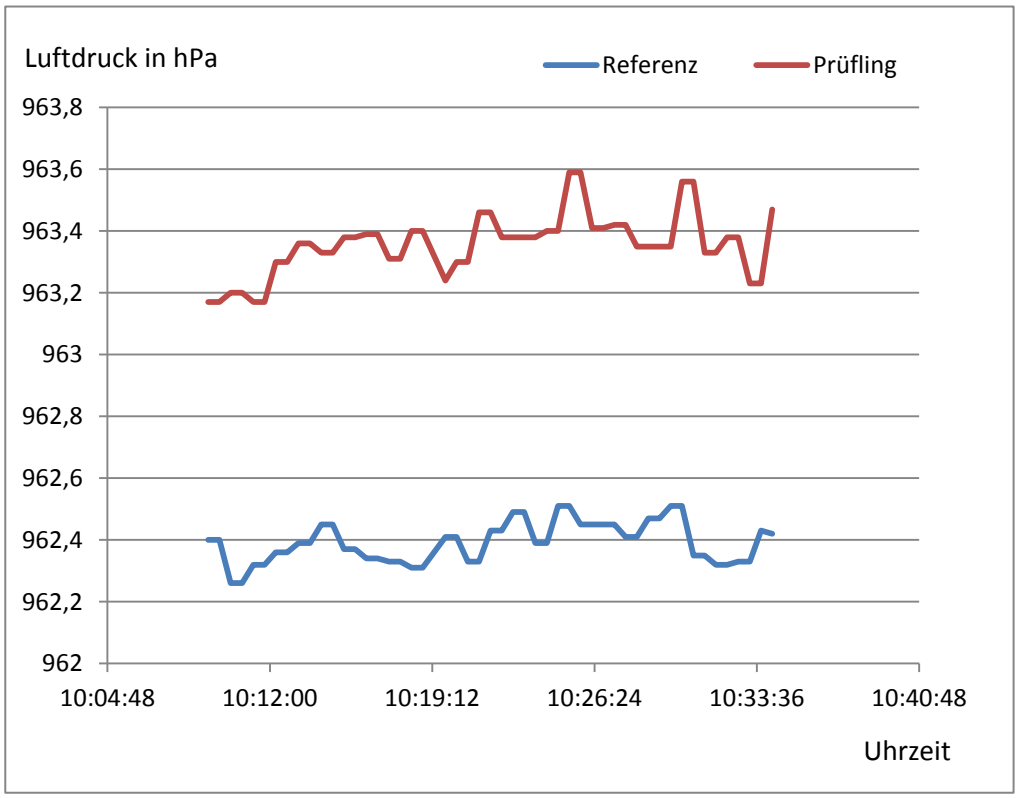

CERTIFIED
DIN EN ISO 9001
NR 70100 F 222
CERTIFICADO

G. LUFFT MESS- UND REGELTECHNIK GMBH
GUTENBERGSTR. 20
70736 FELLBACH
POSTFACH 4252
70719 FELLBACH
TEL: 49 (711) - 51822-0
FAX 49 (711) - 51822-41
INTERNET: http://www.Lufft.de
E-MAIL: Info@Lufft.de

Lufft

Windgeschwindigkeitsverlauf

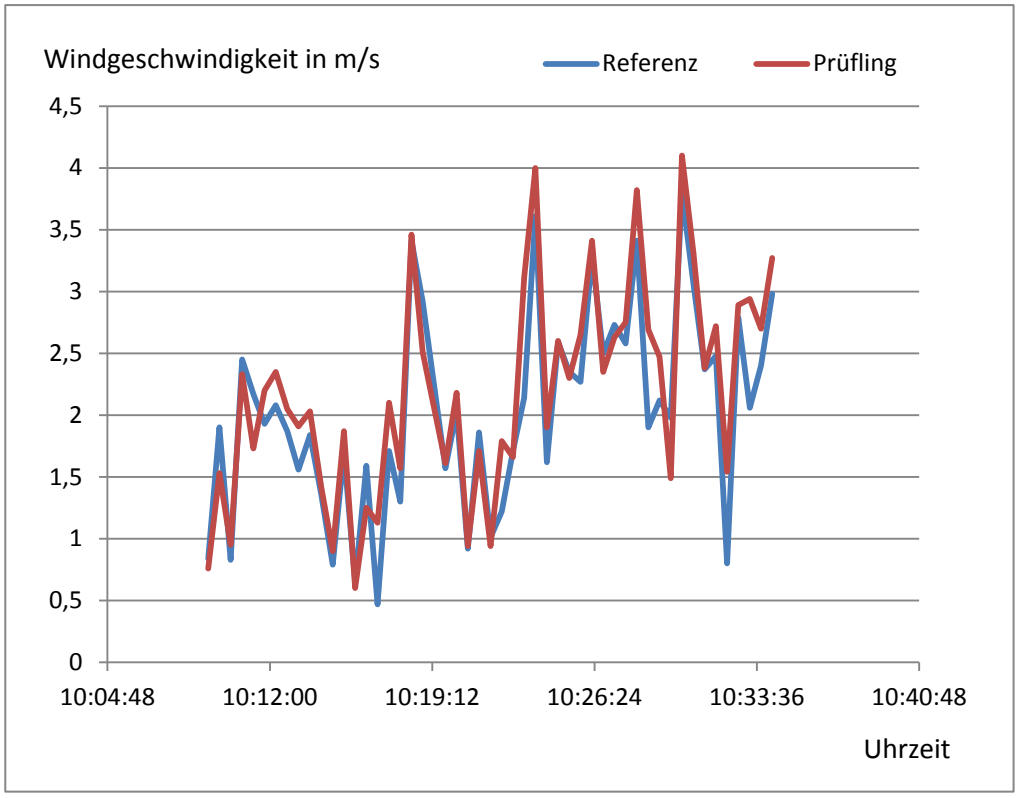

Windrichtungsverlauf

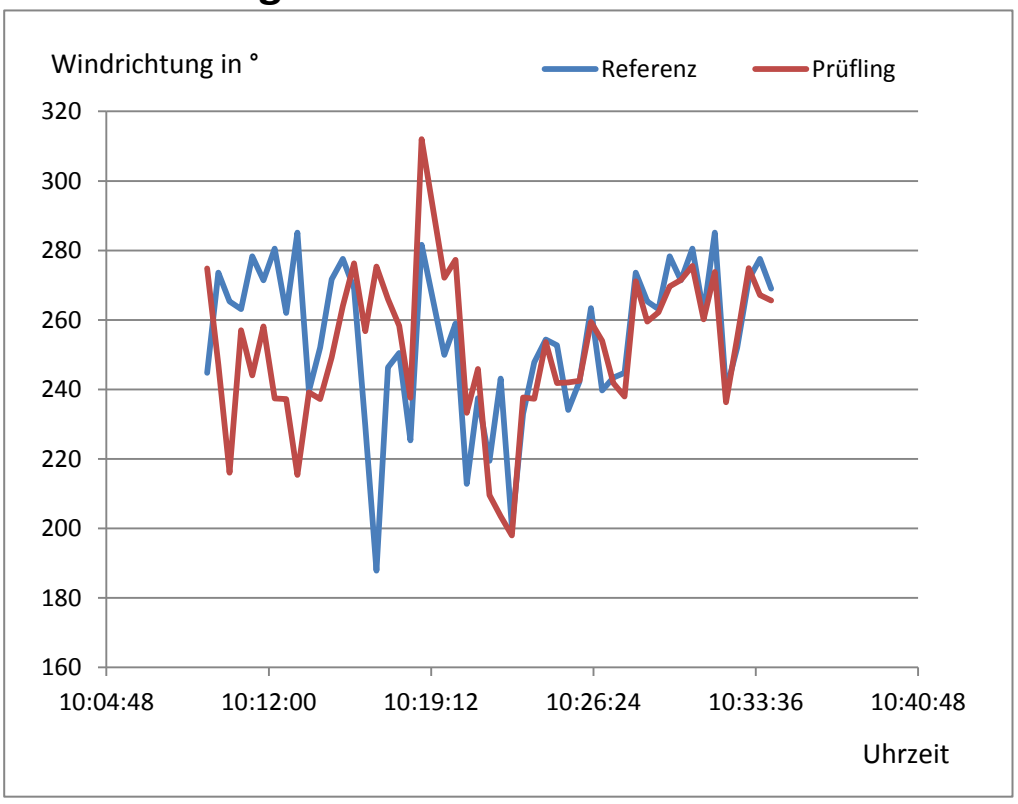

CERTIFIED
DIN EN ISO 9001
NR 70100 F 222
CERTIFICADO

G. LUFFT MESS- UND REGELTECHNIK GMBH
GUTENBERGSTR. 20
70736 FELLBACH
POSTFACH 4252
70719 FELLBACH
TEL: 49 (711) - 51822-0
FAX 49 (711) - 51822-41
INTERNET: http://www.Lufft.de
E-MAIL: Info@Lufft.de

Zusammenfassung

Ergebnisse:	Referenz	Prüfling	Mess-abweichung	Justage empfohlen	Sensortausch empfohlen
Temperatur in °C	11,5	11,9	+0,4	-- NEIN --	-- NEIN --
Taupunkttemperatur in °C	9,9	8,6	-1,3	-- NEIN --	-- NEIN --
Luftfeuchte in %rH	89,9	85,2	-4,7	-- JA -	-- NEIN --
Absolutluftdruck in hPa	962,4	963,4	+1,0	-- NEIN --	-- NEIN --
Windgeschwindigkeit in m/s	2,0	2,2	+0,2	-- NEIN --	-- NEIN --
Windrichtung in °	254,4	251,8	-2,6	-- NEIN --	-- NEIN --

Anmerkung: Messabweichung außerhalb der festgelegtenToleranz bei der Messung der Luftfeuchte. Daher lautet unsere Empfehlung, eine Justage der Luftfeuchte vorzunehmen.